

電動モルセレータ販売停止に 関するアンケート調査集計

一般社団法人 日本産科婦人科内視鏡学会
2014年5月13日～19日

電動モルセレータの使用状況

電動モルセレータの使用

単位：人数

使用している	318
使用していない	48

使用している機材

単位：人数

J&J社製	255
KARL STORZ社製	29
上記の両方	39


販売停止になったら

単位：人数


困る	302
困らない	64

電動モルセレータの使用状況


電動モルセレータの使用



現在使用しているデバイス



発売停止に対して

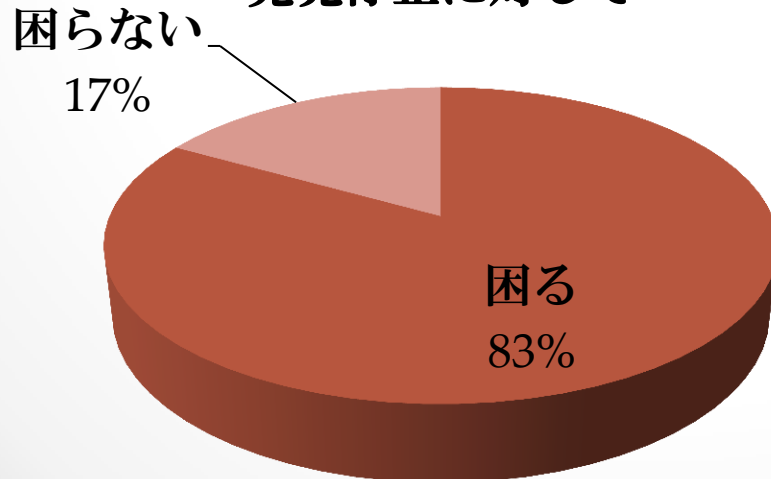

代替対応

単位：人数

項目	回答数
LMをやめる	32
開腹術にする	52
代替回収法を採用	161
その他	121



代替回収法（術式）の内訳

項目	回答数	補足
臍から回収	24	単孔式デバイスの使用を含む
腹壁創部から回収	21	通常の創部を拡げる（開窓器使用含む）
LAMなど	119	腹壁小切開、開窓器使用、つり上げ式含む
腔から回収	72	回収袋使用・筋腫細切含む
筋腫の細切	15	経腔・臍・腹壁からの回収と組み合わせ
他社製品の使用	7	リユースタイプ

代替対応

